




Escala/**Scale:** 1:5
Dimensiones/**Dimensions.** ±4%

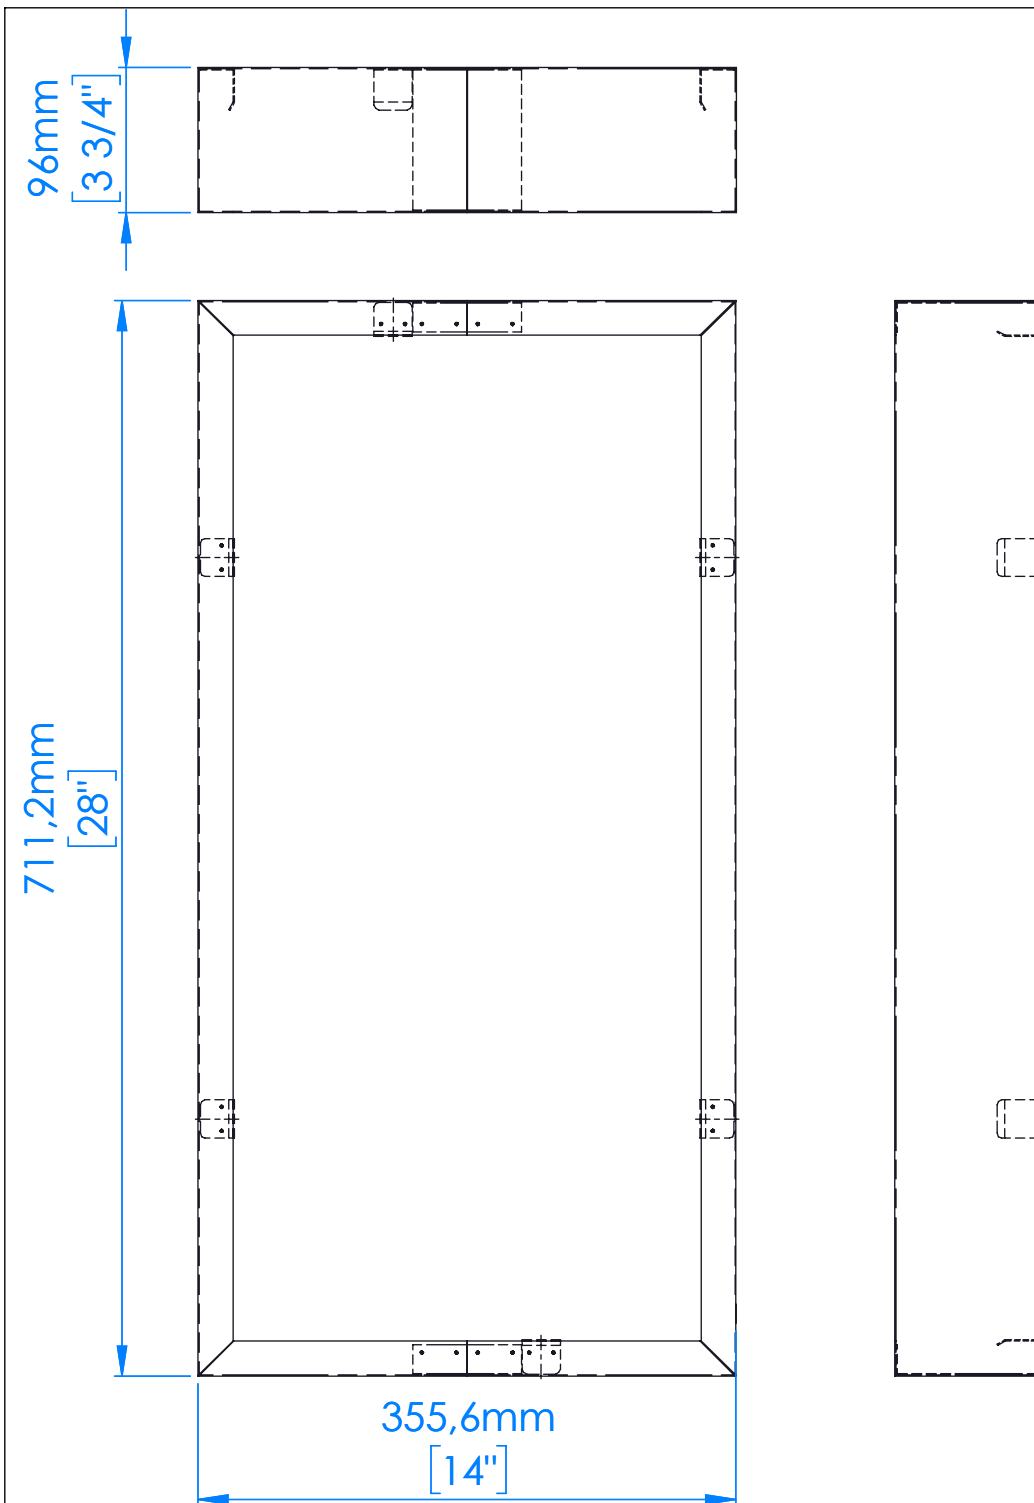

Marco para montaje en superficie DTE0030CS
Surface mount frame DTE0030CS

Ref. / Code	Material	Acabado / Finish
KT0030CS	AISI 304	Satinado / Satin

Fecha / **Date:** 27/08/2025

www.mediclinics.com

